


SVARĪGA PIEZĪME: Svītrkoda izmaiņas Cook izstrādājumu etiķetēs

2016. gada aprīlī Cook Medical sāks izņemt vienu no diviem svītrkodiem savu izstrādājumu etiķetēs. Pašlaik Cook etiķetēs ir divi svītrkodi – īss svītrkods pie izstrādājuma etiķetes augšmalas un garš svītrkods pie izstrādājuma etiķetes apakšmalas.

Garais svītrkods satur izstrādājuma GS1 Globālo tirdzniecības vienības numuru (GTIN), sērijas numuru un derīguma termiņu. Tā kā īsais svītrkods satur GTIN, kas ir arī garajā svītrkodā, īsais svītrkods no mūsu izstrādājumu etiķetēm tiks izņemts. Pēc īsā svītrkoda dzēšanas mūsu izstrādājumu etiķetes kļūs vienkāršākas, jo tiks izņemta lieka informācija.

Jautājumu gadījumā varat sazināties ar pakalpojumu centru "Shared Service Center" pa e-pastu un tālruni: ssc.distributors@cookmedical.com vai +353 61239240

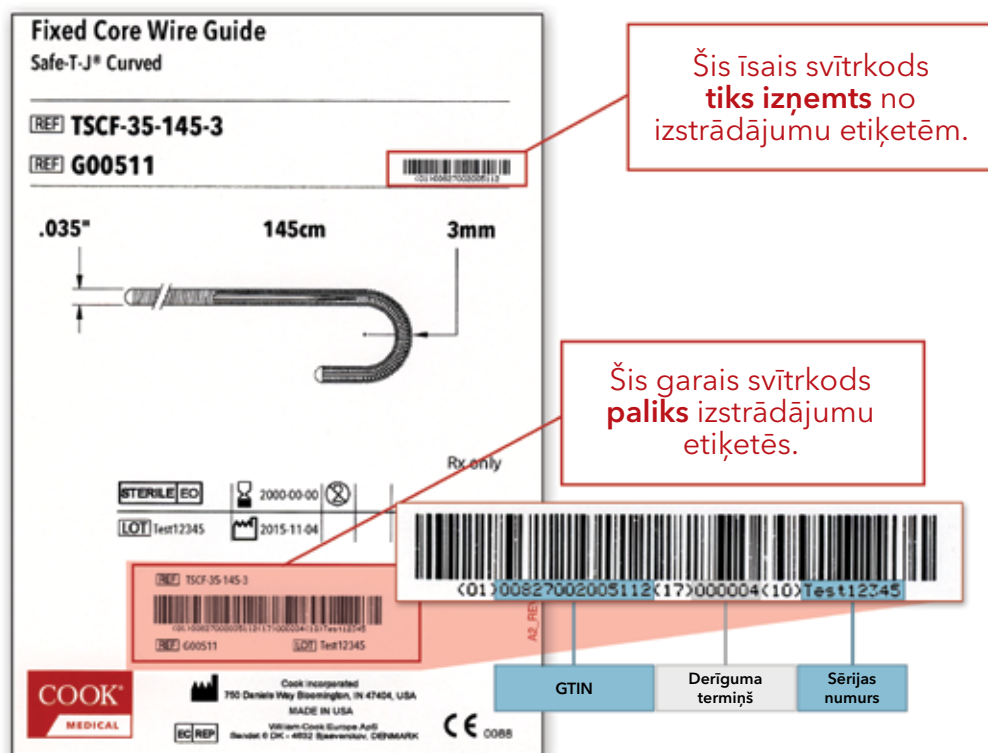

Biežāk uzdotie jautājumi

Atbildes uz jūsu jautājumiem par svītrkodu izmaiņām Cook Medical izstrādājumu etiķetēs

Kas izmainīsies Cook izstrādājumu etiķetēs?

Pašlaik Cook etiķetēs ir divi svītrkodi – īss svītrkods pie izstrādājuma etiķetes augšmalas un garš svītrkods pie izstrādājuma etiķetes apakšmalas. Īsais svītrkods no mūsu izstrādājumu etiķetēm tiks izņemts.

Kad notiks šīs izmaiņas?

Īso svītrkodu, kas pašlaik ir mūsu izstrādājumu etiķetēs, Cook Medical sāks izņemt 2016. gada aprīlī. Pēc šī datuma jūs joprojām redzēsiet īsos svītrkodus izstrādājumu etiķetēs, kas drukātas pirms 2016. gada aprīļa, un uz izstrādājumu etiķetēm no tām Cook ražotnēm, kurās vēl nebūs apturēta īso svītrkodu drukāšana. Galu galā īso svītrkodu drukāšanu vairs neturpinās neviena no Cook ražotnēm.

Kādēļ īsais svītrkods tiek izņemts no mūsu izstrādājumu etiķetēm?

Garais svītrkods satur to pašu informāciju, ko īsais svītrkods. Izņemot īso svītrkodu, tiks izņemta liekā informācija un izstrādājumu etiķetes kļūs vienkāršākas.

Ar ko sazināties, ja nepieciešama palīdzība?

- Sazinieties ar savu programmatūras nodrošinātāju, ja jums ir šādas problēmas:
 - skeneris nevar nolasīt garo svītrkodu,
 - programmatūra svītrkodā nevar atdalīt GTIN, sērijas numuru un derīguma termiņu.
- Sazinieties ar Cook kopējo pakalpojumu centru „Shared Service Center” pa ssc.distributors@cookmedical.com vai +353 61239240, ja jums ir šāda problēma:
- skeneris nolasa garo svītrkodu, bet vai nu trūkst datu, vai arī tie neielādējas jūsu programmatūras sistēmā.

Kādu informāciju satur mūsu garais svītrkods?

