


VIKTIG MERKNAD: En endring i strekkodene på Cooks produktetiketter

I april 2016 vil Cook Medical begynne å fase ut én av de to strekkodene på produktetikettene våre. For tiden har etikettene to strekkoder: en kort strekkode nær toppen av produktetikettene, og en lang strekkode nær bunnen av produktetikettene.

Den lange strekkoden inneholder produktets globale GS1-handelsvarenummer (GTIN), partinummer og utløpsdato. Fordi den korte strekkoden inneholder GTIN-nummeret som også finnes i den lange strekkoden, fjerner vi den korte strekkoden fra produktetikettene våre. Ved å fjerne den korte strekkoden blir produktetikettene enklere, og overflødig informasjon blir eliminert.

Hvis du har spørsmål, kontakt vårt Shared Service Center på no.orders@cookmedical.com eller +47 23162968

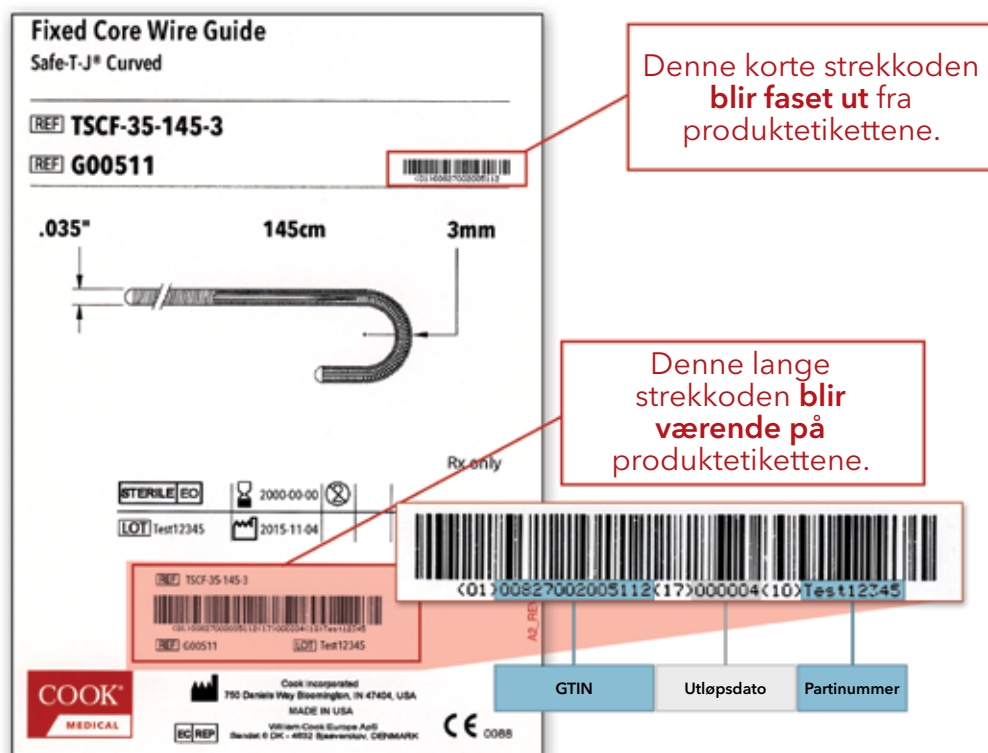

Vanlige spørsmål

Svar på spørsmål angående endringen i strekkodene på Cook Medicals produktetiketter

Hva blir endret på Cooks produktetiketter?

Produktetikettene våre har for tiden to strekkoder: en kort strekkode nær toppen av produktetikettene, og en lang strekkode nær bunnen av produktetikettene. Vi kommer til å fjerne den korte strekkoden på produktetikettene.

Når vil endringen finne sted?

I april 2016 vil Cook begynne å fase ut de korte strekkodene som nå finnes på etikettene våre. Etter denne datoen vil du kanskje fortsatt se de korte strekkodene på produktetiketter som ble skrevet ut før april 2016 og på produktetiketter fra Cook-anlegg som ennå ikke har stanset utskrift av korte strekkoder. Til slutt vil alle Cook-anlegg stanse utskriften av korte strekkoder på Cooks produktetiketter.

Hvorfor fjerner vi den korte strekkoden fra produktetikettene?

Den lange strekkoden inneholder informasjonen i den korte strekkoden. Ved å fjerne den korte strekkoden eliminerer vi overflødig informasjon og forenkler produktetikettene.

Hvem skal du kontakte hvis du trenger hjelp?

- Kontakt leverandøren av skannerprogramvaren hvis du har disse problemene:
 - Skanneren kan ikke avlese den lange strekkoden.
 - Programvaren kan ikke skille GTIN-nummeret, partinummeret og utløpsdatoen fra hverandre i strekkodedataene.
- Kontakt Cooks Shared Service Center på no.orders@cookmedical.com eller +47 23162968 hvis du har dette problemet:
- Skanneren avleser den lange strekkoden, men dataene mangler eller lastes ikke inn i programvaresystemet.

Hvilken informasjon finnes i den lange strekkoden?

