


ประกาศสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงบาร์โค้ดบนฉลากผลิตภัณฑ์ของ Cook

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 บริษัท Cook Medical จะเริ่มยกเลิกการใช้หนึ่งในบาร์โค้ดที่แสดงอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์ของเรา ขณะนี้ฉลากของเรามีบาร์โค้ดสองแถบ คือ บาร์โค้ดแถบสั้นที่อยู่ใกล้กับส่วนบนสุดของฉลากผลิตภัณฑ์และบาร์โค้ดแถวยาวที่อยู่ใกล้กับส่วนล่างสุดของฉลากผลิตภัณฑ์

บาร์โค้ดแถวยาวประกอบด้วยหมายเลขประจำรายการทางการค้าสากล (Global Trade Item Number, GTIN) GS1 หมายเลขล็อต และวันที่หมดอายุของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบาร์โค้ดแถบสั้นมี GTIN ที่มีอยู่ในบาร์โค้ดแถวยาวด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจึงอยู่ระหว่างการดำเนินการลบบาร์โค้ดแถบสั้นออกจากฉลากผลิตภัณฑ์ของเรา การลบบาร์โค้ดแถบสั้นออกไปจะทำให้ฉลากผลิตภัณฑ์ของเราดูง่ายขึ้น และจะเป็นการลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนออกไป

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถติดต่อ Shared Service Center ที่
th.orders@cookmedical.com หรือ +662 1688630

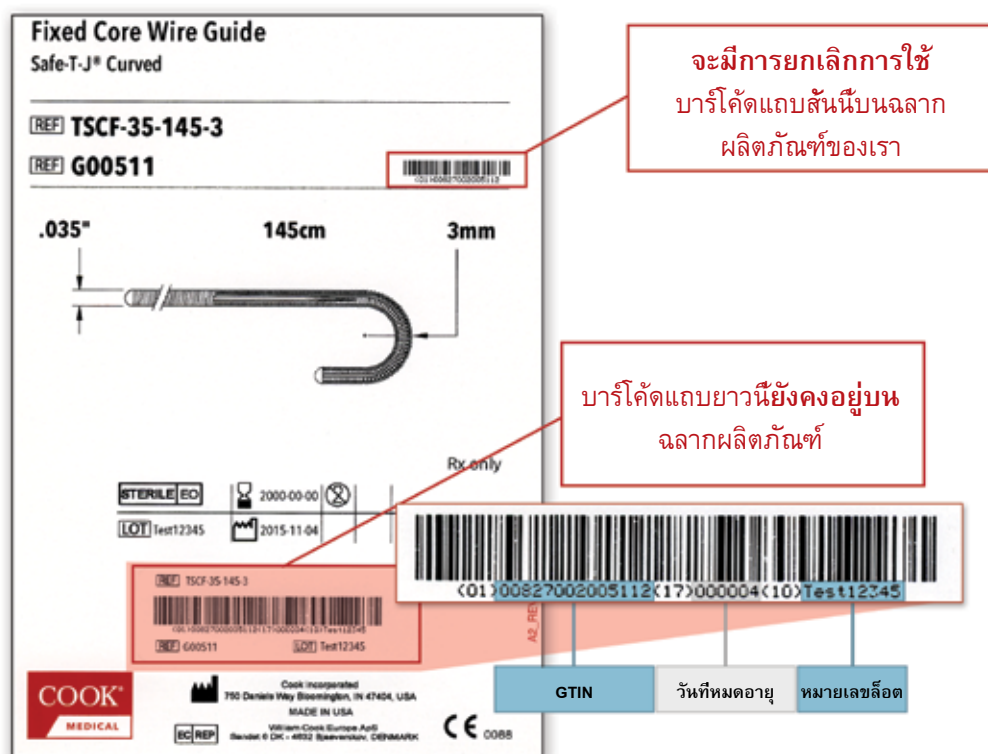

Fixed Core Wire Guide
Safe-T-J® Curved

REF TSCF-35-145-3
REF G00511

.035" 145cm 3mm

Rx only

STERILE EO 2000-00-00
LOT Test12345 2015-11-04

COOK MEDICAL Cook Incorporated 750 Daniels Way Birmingham, AL 37404, USA MADE IN USA
Villum Cook Europe ApS Sønder Ø DK - 4852 Sønderborg, DENMARK CE 0088

จะมีการยกเลิกการใช้ บาร์โค้ดแถบสั้นบนฉลาก ผลิตภัณฑ์ของเรา

บาร์โค้ดแถวยาวนี้ยังคงอยู่บน ฉลากผลิตภัณฑ์

GTIN วันที่หมดอายุ หมายเลขล็อต

คำถามโดยทั่วไป

คำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบาร์โค้ดบนฉลากผลิตภัณฑ์ของ Cook Medical

จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างบนฉลากผลิตภัณฑ์ของ Cook

ขณะนี้ฉลากของเรามีบาร์โค้ดสองแถบ คือ บาร์โค้ดแถบสั้นที่อยู่ใกล้กับส่วนบนสุดของฉลากผลิตภัณฑ์และบาร์โค้ดแถวยาวที่อยู่ใกล้กับส่วนล่างสุดของฉลากผลิตภัณฑ์ เราจะลบบาร์โค้ดแถบสั้นบนฉลากผลิตภัณฑ์ของเราออกไป

การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 Cook จะเริ่มยกเลิกการใช้บาร์โค้ดแถบสั้นที่แสดงอยู่บนฉลากของเราในปัจจุบัน หลังจากวันนี้นี้ ท่านอาจยังคงเห็นบาร์โค้ดแถบสั้นอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์ไว้ก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 และบนฉลากผลิตภัณฑ์จากโรงงานของ Cook ที่ยังไม่มีการหยุดพิมพ์บาร์โค้ดแถบสั้น อย่างไรก็ตาม สุดท้ายโรงงานของ Cook ทั้งหมดจะไม่มีบาร์โค้ดแถบสั้นบนฉลากผลิตภัณฑ์ของ Cook อีกต่อไป

เพราะเหตุใดเราจึงลบบาร์โค้ดแถบสั้นออกจากฉลากผลิตภัณฑ์ของเรา

บาร์โค้ดแถวยาวมีข้อมูลที่อยู่ในบาร์โค้ดแถบสั้น ในการลบบาร์โค้ดแถบสั้นออกไป จะเป็นการลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนออกไปและทำให้ฉลากผลิตภัณฑ์ของเราดูง่ายขึ้น

ผู้ใดที่ท่านสามารถติดต่อได้หากท่านต้องการความช่วยเหลือ

- ติดต่อผู้ให้บริการซอฟต์แวร์หากท่านมีปัญหาเหล่านี้:
 - เครื่องสแกนเนอร์ไม่สามารถอ่านบาร์โค้ดแถวยาวได้
 - ซอฟต์แวร์ไม่สามารถแยกข้อมูลในบาร์โค้ดออกเป็น GTIN หมายเลขล็อต และวันที่หมดอายุ
 - ติดต่อ Shared Service Center ของ Cook ที่ th.orders@cookmedical.com หรือ +662 1688630 หากท่านมีปัญหา:
 - เครื่องสแกนอ่านบาร์โค้ดแถวยาว แต่ข้อมูลหายไปหรือไม่โหลดเข้าระบบซอฟต์แวร์ของท่าน

มีข้อมูลอะไรอยู่ในบาร์โค้ดแถวยาวบ้าง

